


IGPSPORT

QUICK START MANUAL

HR70



WUHAN QIWU TECHNOLOGY CO., LTD

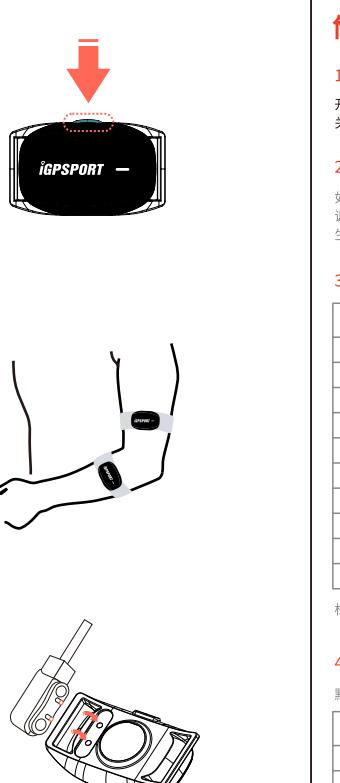

PORTUGUÊS

1. LIGAR/DESLIGAR HR70

Ligar: pressione por 1s, a luz indicadora azul piscará 3 vezes rapidamente e HR70 vibrará.
Desligar: Mantenha pressionado por 2s, a luz indicadora vermelha piscará 3 vezes rapidamente e HR70 vibrará.

2. COMO USAR

Como a imagem 2 mostra abaixo, você pode usar o monitor de frequência cardíaca na parte do braço ou antebraço. Por favor, ajuste o comprimento da banda para que ela se encaixe perfeitamente no braço e verifique se de que a banda do braço não se move durante o exercício para garantir a precisão da medição da frequência cardíaca.

3. FUNÇÕES PRINCIPAIS

Funções	Status ou ação
Ligar	A luz azul piscará 3 vezes rapidamente e o dispositivo vibrará
Desligar	A luz vermelha piscará 3 vezes rapidamente e o dispositivo vibrará
Carregamento	A luz azul piscará lentamente
Carregamento concluído	Luz verde se mantém acesa sempre
Indicação da zona de frequência cardíaca	A cor correspondente à zona de frequência cardíaca piscará lentamente
Alerta de frequência cardíaca baixa*	A luz azul piscará 3 vezes rapidamente e o dispositivo vibrará
Alerta de Frequência Cardíaca Alta*	A luz vermelha piscará 3 vezes rapidamente e o dispositivo vibrará
Alteração do modo*	Quando o HR70 estiver ligado, pressione rapidamente duas vezes o botão para alternar o modo
Alerta de bateria fraca (inferior a 9%, 5%)	A luz vermelha piscará 3 vezes rapidamente e o dispositivo vibrará
Atualização do firmware	A luz azul se mantém acesa sempre

成品单页尺寸:125x58mm

材质:128g双铜纸

样式:正反双面印刷,折叠页


IGPSPORT

QUICK START MANUAL

HR70



WUHAN QIWU TECHNOLOGY CO., LTD

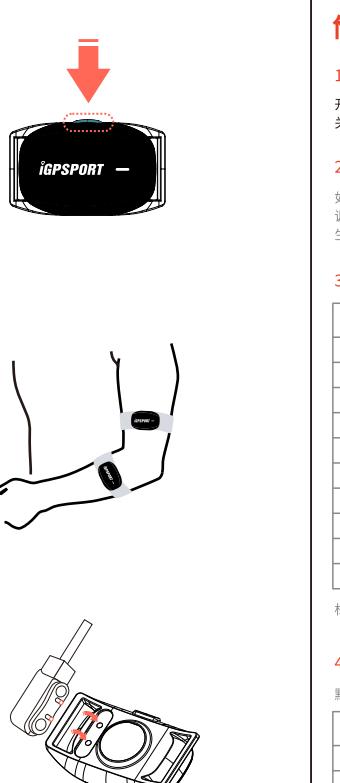

FRANÇAIS

1. ALLUMER/ÉTEINDRE

Allumer: appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde, le voyant bleu clignote 3 fois rapidement et vibre.
Éteindre: appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, le voyant bleu clignote 3 fois rapidement et vibre.

2. LE PORT

Le brassard de fréquence cardiaque peut être porté à l'intérieur ou à l'extérieur du haut du bras ou de l'avant-bras, comme indiqué sur la deuxième photo de démonstration. Veillez ajuster la longueur de la bande de manière à ce qu'elle s'adapte confortablement à votre bras et permette à ce que le brassard ne se déplace pas pendant l'exercice pour garantir la précision de la mesure de la fréquence cardiaque.

3. CARREGEMENT

- Usando o método de carregamento magnético. Ao carregar, insira uma extremidade do cabo de carregamento magnético na porta USB e conecte a outra extremidade à banda de braço de frequência cardíaca.

- Durante o carregamento, a luz indicadora LED piscará em azul, e quando estiver totalmente carregado, a luz indicadora LED ficará verde.

3. FUNÇÕES PRINCIPAIS

Funções	Status ou ação
Ligar	A luz azul piscará 3 vezes rapidamente e o dispositivo vibrará
Desligar	A luz vermelha piscará 3 vezes rapidamente e o dispositivo vibrará
Carregamento	A luz azul piscará lentamente
Carregamento concluído	Luz verde se mantém acesa sempre
Indicação da zona de frequência cardíaca	A cor correspondente à zona de frequência cardíaca piscará lentamente
Alerta de frequência cardíaca baixa*	A luz azul piscará 3 vezes rapidamente e o dispositivo vibrará
Alerta de Frequência Cardíaca Alta*	A luz vermelha piscará 3 vezes rapidamente e o dispositivo vibrará
Alteração do modo*	Quando o HR70 estiver ligado, pressione rapidamente duas vezes o botão para alternar o modo
Alerta de bateria fraca (inferior a 9%, 5%)	A luz vermelha piscará 3 vezes rapidamente e o dispositivo vibrará
Atualização do firmware	A luz azul se mantém acesa sempre

Notas: As funções marcadas com * precisam ser definidas no Aplicativo IGPSPORT.

4. INDICAÇÃO DA ZONA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA

A frequência cardíaca máxima por padrão é 195 bpm e as zonas de frequência cardíaca são calculadas conforme o método de frequência cardíaca máxima.

MANUAL DO USUÁRIO

Faça login no site oficial para ver os detalhes do manual do usuário
Site e código QR:
<https://www.igpsport.com/user-manual>

4. INDICATION D'INTERVALLE DE FRÉQUENCE CARDIAQUE

La valeur de fréquence cardiaque maximale par défaut est de 195 bpm et les intervalles de fréquence cardiaque sont calculés à l'aide de la méthode de fréquence cardiaque maximale.

简体中文

1. 开关机

开机:短按1s,蓝灯快速闪烁3次,并震动。
关机:长按2s,红灯快速闪烁3次,并震动。

2. 戴戴

如图2所示,您可将心率臂带佩戴在上臂或前臂的内侧或外侧。请调节绳子长度,使之舒适的紧贴在手臂上,并确保运动中臂带不产生位移,以保证心率测量的准确性。

3. 主要功能

功能	状态或操作
开机	蓝灯快速闪烁3次,并震动
关机	红灯快速闪烁3次,并震动
充电中	蓝灯慢速闪烁
充电完成	绿灯常亮
心率区间指示	心率区间对应颜色慢速闪烁
心率低值警示*	蓝灯快速闪烁3次,并震动
心率高值警示*	红灯快速闪烁3次,并震动
模式切换*	开机状态下双击按键
低电量警示(低于9%, 5%)	红灯快速闪烁3次,并震动
固件升级	蓝灯常亮

标*的功能需要在IGPSPORT APP中进行设置。

4. 心率区间指示

默认最大心率值为195 bpm,心率区间采用最大心率法计算。

心率区间	状态
区间一(50-60%)	蓝灯慢速闪烁
区间二(60-70%)	绿灯慢速闪烁
区间三(70-80%)	黄灯慢速闪烁
区间四(80-90%)	红灯慢速闪烁
区间五(90-100%)	紫灯慢速闪烁

标*的功能需要在IGPSPORT APP中进行设置。

5. 产品配件

- HR70主机 × 1

- 背带 × 1

- 磁吸式充电线 × 1

- 快速使用说明书 × 1

6. 产品配件

- HR70 main unit × 1

- Armband × 1

- Magnetic charging cable × 1

- HR70 User Quick Guide × 1

7. 联系我们

www.igpsport.com

武汉齐物科技有限公司

⑧ 武汉市洪山区野芷湖西路16号创意天地D区04号创意工坊3层

⑨ (86)027-87835568

⑩ service@igpsport.com

声明:

本说明书仅供用户参考,若与设备有差异,请以设备为准。我们保留更改或改进我们产品的权利,以及更改本手册内容的权利,但没有义务将此类更改或改进通知任何个人或组织。

武汉齐物科技有限公司版权所有。

6. 产品配件

- HR70 main unit × 1

- Armband × 1

- Magnetic charging cable × 1

- HR70 User Quick Guide × 1

7. CONTACT US

www.igpsport.com

Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd.

⑧ 3/F Creative Workshop, No.04 District D Creative World, No.16 West Yezihu Road, Hongshan District, Wuhan, Hubei, China.

⑨ (86)027-87835568

⑩ service@igpsport.com

声明:

本说明书仅供用户参考,若与设备有差异,请以设备为准。我们保留更改或改进我们产品的权利,以及更改本手册内容的权利,但没有义务将此类更改或改进通知任何个人或组织。

武汉齐物科技有限公司版权所有。

6. 产品配件

- HR70 main unit × 1

- Armband × 1

- Magnetic charging cable × 1

- HR70 User Quick Guide × 1

7. CONTACT US

www.igpsport.com

Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd.

⑧ 3/F Creative Workshop, No. 04, District D, Creative World, No. 16, Yezihu West Road, Hongshan District, Wuhan, Hubei, China.

⑨ (86)027-87835568

⑩ service@igpsport.com

声明:

本说明书仅供用户参考,若与设备有差异,请以设备为准。我们保留更改或改进我们产品的权利,以及更改本手册内容的权利,但没有义务将此类更改或改进通知任何个人或组织。

武汉齐物科技有限公司版权所有。

6. 产品配件

- HR70 main unit × 1

- Armband × 1

- Magnetic charging cable × 1

- HR70 User Quick Guide × 1

7. CONTACT-US-NO

www.igpsport.com

Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd.

⑧ 3/F Creative Workshop, No. 04, District D, Creative World, No. 16, Yezihu West Road, Hongshan District, Wuhan, Hubei, China.

⑨ (86)027-87835568

⑩ service@igpsport.com

声明:

本说明书仅供用户参考,若与设备有差异,请以设备为准。我们保留更改或改进我们产品的权利,以及更改本手册内容的权利,但没有义务将此类更改或改进通知任何个人或组织。

武汉齐物科技有限公司版权所有。

6. 产品配件

- HR70 main unit ×

WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction

FCC ID: 2AU4M-HR70

SPECIFICATIONS:

Operating Temperature: -10°C -50°C

WARNING

Manufacturer's Name: Wuhan Qiwu Technology Co.,Ltd.

Address: 3 / F, Creative workshop, No.04, District D, Creative world, No.16 Yezhihu West Road, Hongshan District, Wuhan City, Hubei Province, China.

Product Name: Heart Rate

Model number: HR70,HR70S, HR70P, HR70C, HR70 PLUS, HR70 PRO

This product can be used across all EU member states.

Hereby, Wuhan Qiwu Technology Co.,Ltd. declares that this BIKE SMART COMPUTER product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. A copy of the Declaration of Conformity can be found at Website:

www.igpsport.cn

CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

Care for the environment! Must not be discarded with household waste!

For RF Specification

Function	Operation Frequency	Max RF output power:	Limit
BLE(1M)	2402MHz–2480MHz	-3.56dBm	20 dBm.
BLE(2M)	2402MHz–2480MHz	-3.47dBm	20 dBm.
ANT+(1M)	2457MHz	-3.23dBm	20 dBm.
ANT+(2M)	2457MHz	-3.47dBm	20 dBm.

