


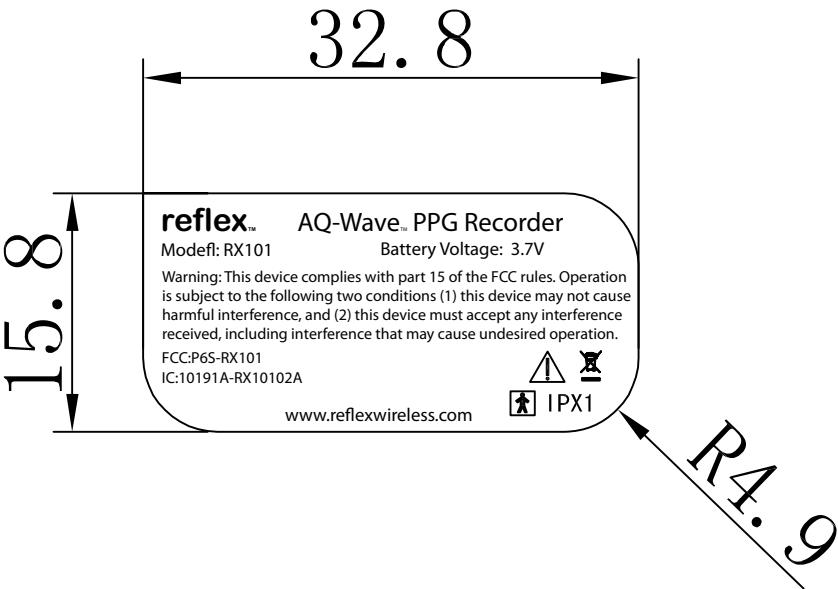

- 技术要求
- 1. 文字按图示位置均匀排布，文字为**Arial**字体。
 - 2. 字为黑色，底色为银灰色，公司标志为红色。
 - 3. 背面粘有不干胶。
 - 4. 不带边框。
 - 5. 单位为毫米。

					CMS50EW 脉搏血氧仪 英文铭牌	CMS8.807.107E/1.2			
标记	数量	更改单号	签名	日期					
设计		张海娜	2010. 05. 17						
审核		张金玲	2010. 05. 17		亚银覆膜	阶段标记		质量	比例
						B			2:1
						第 1 张		共 1 张	
标准化		武晓琳	2010. 05. 17			康泰医学系统有限公司			
批准		许云龙	2010. 05. 17						